



TITRONIC[®] et TitroLine[®]

Nouveaux titrateurs et burettes




SI Analytics

www.si-analytics.com


Un pas en avant dans

Les nouveaux titrateurs TitroLine® 6000 et 7000 ainsi que
la nouvelle burette à piston TITRONIC® 500
transforment la titration en une analyse simple grâce ...

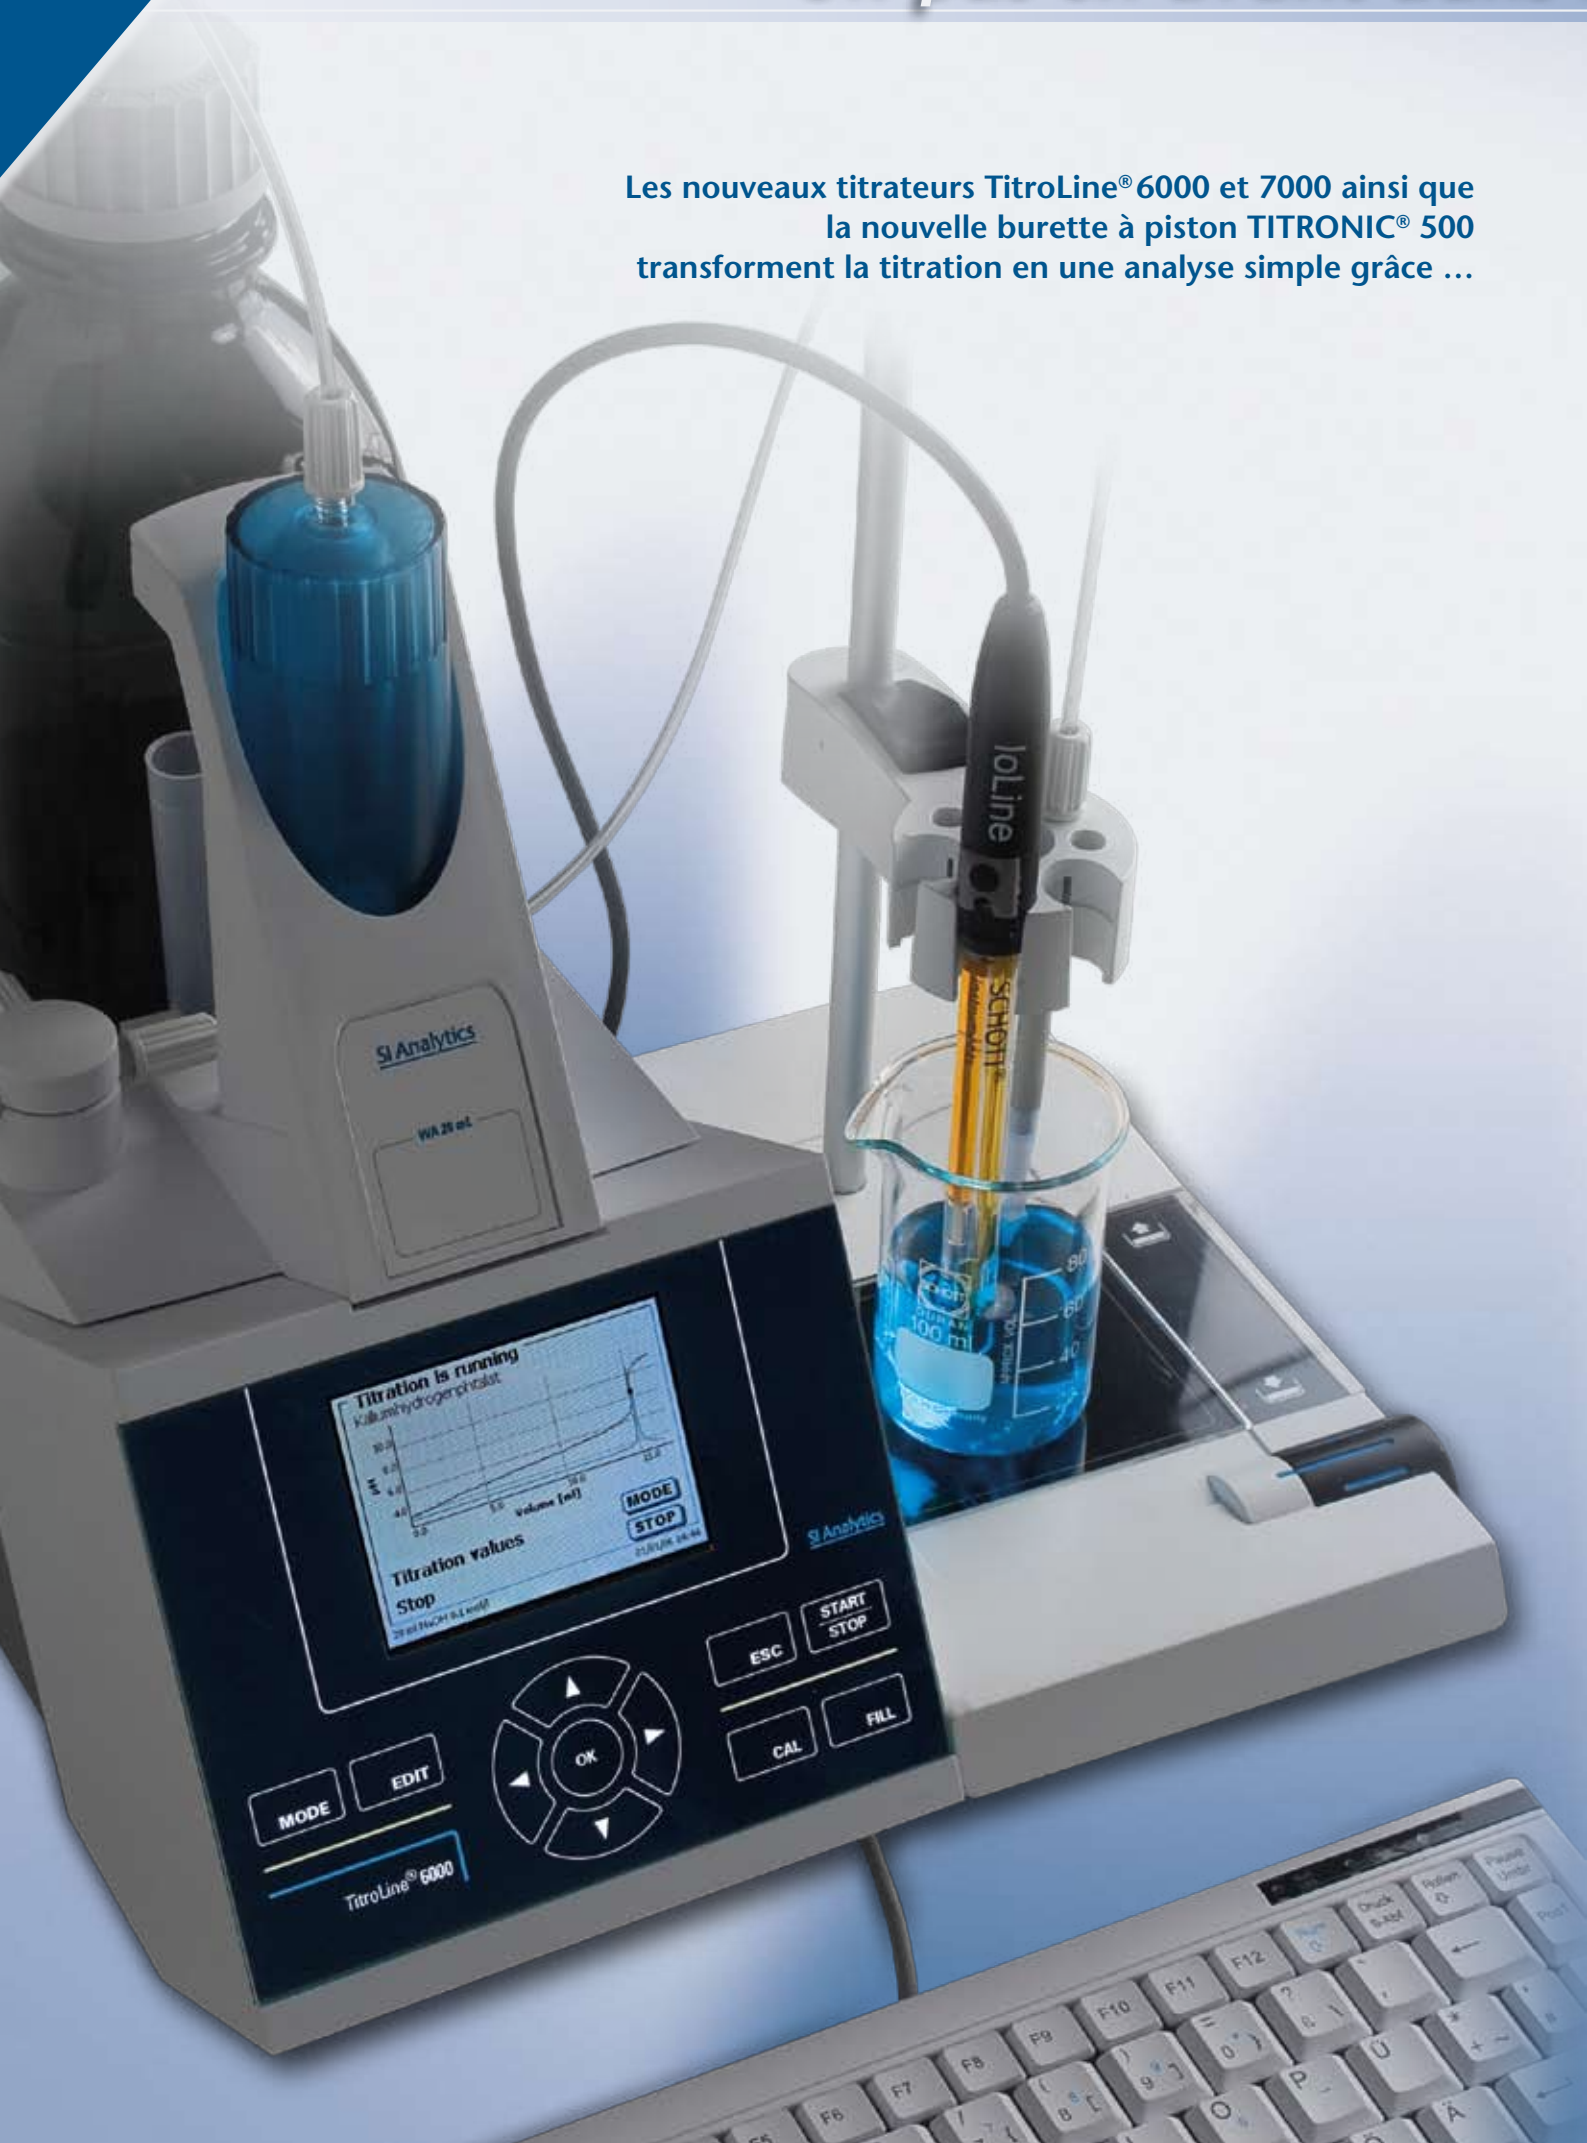

TitroLine® 6000 / TitroLine® 7000

Titrateurs

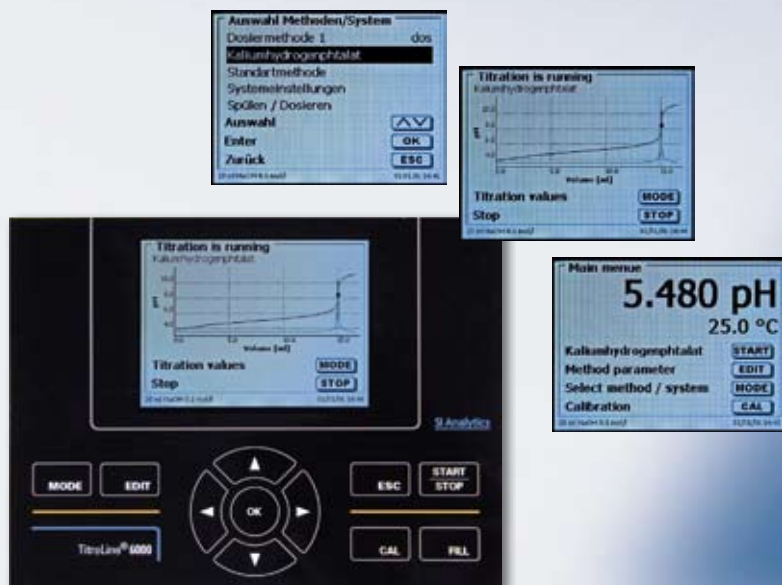

- ... l'écran brillant TFT permet une vision parfaite même sur le côté.
- ... l'unité de dosage interchangeable enregistre les données du réactif et de l'unité de dosage.
- ... la reconnaissance automatique sans fil des électrodes ID SCHOTT® Instruments assurant la plus grande fiabilité de l'étalonnage et des mesures.
- ... les touches tactiles du clavier en verre est un plaisir à utiliser.
- ... 3 interfaces USB et 2 interfaces RS-232 permettent de connecter par ex., de clavier USB, imprimante USB, stockage de données USB, agitateur, balance et autres appareils de SI Analytics.



TITRONIC® 500

Burette à piston



Spécifications du TitroLine® 6000, 7000 et TITRONIC® 500

Spécifications	TITRONIC® 500	TitroLine® 6000	TitroLine® 7000
Entrée pH/mV et électrode de référence	–	1	1
Reconnaissance d'électrode sans fil	–	–	✓
Entrée Dead Stop (2 x fiches 4 mm)	–	✓	✓
Entrée pour mesure de la température (2 x fiches 4 mm)		✓	✓
Interfaces	3 USB, 2 RS232	3 USB, 2 RS232	3 USB, 2 RS232
Titration à point final (EP), pH et mV	–	2 EP	2 EP
Titration dynamique et linéaire à point d'équivalence (EQ), pH et mV	–	1 EQ	2 EQ
Particulièrement conseillé pour milieux non aqueux	–	–	✓
Titration Dead Stop	–	✓	✓
Titration pH-stat	–	–	✓
Titration manuelles	✓	✓	✓
Distribution de volumes	✓	✓	✓
Préparation de solutions (manuelle ou automatique par raccordement de balance)	✓	–	✓
Formules pour différents calculs	✓	✓	✓
Méthodes standards	✓	✓	✓
Nombre de méthodes	5	> 10	50

Informations pour commander

Ensemble	Contient:	n° commande
T 500-M1 TITRONIC® 500 avec agitateur magnétique	appareil de base TITRONIC® 500 avec agitateur magnétique TM235, statif TZ1510, porte-électrode Z 305, commande manuelle TZ 3880, bloc d'alimentation 100–240V	285220210
T 500-M2/20 TITRONIC® 500 avec agitateur magnétique et unité interchangeable de 20 ml	appareil de base TITRONIC® 500 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 20 ml WA20, statif TZ1510, porte-électrode Z 305, commande manuelle TZ 3880, bloc d'alimentation 100–240V	285220220
TL 6000-M1/10 TitroLine® 6000 avec unité interchangeable de 10 ml	appareil de base TitroLine® 6000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 10 ml WA10, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220050
TL 6000-M1/20 TitroLine® 6000 avec unité interchangeable de 20 ml	appareil de base TitroLine® 6000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 20 ml WA20, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220060
TL 6000-M1/50 TitroLine® 6000 avec unité interchangeable de 50 ml	appareil de base TitroLine® 6000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 50 ml WA50, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220070
TL 6000-M2/20 TitroLine® 6000 avec unité interchangeable de 20 ml et électrode pH	appareil de base TitroLine® 6000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 20 ml WA20, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration avec électrode pH combinée IL-pHT-A120MF-DIN-N et solutions tampon	285220080
TL 7000-M1/10 TitroLine® 7000 avec unité interchangeable de 10 ml	appareil de base TitroLine® 7000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 10 ml WA10, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220140
TL 7000-M1/20 TitroLine® 7000 avec unité interchangeable de 20 ml	appareil de base TitroLine® 7000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 20 ml WA20, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220150
TL 7000-M1/50 TitroLine® 7000 avec unité interchangeable de 50 ml	appareil de base TitroLine® 7000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 50 ml WA50, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration	285220160
TL 7000-M2/20 TitroLine® 7000 avec unité interchangeable de 20 ml et électrode pH	appareil de base TitroLine® 7000 avec agitateur magnétique TM235, unité interchangeable de 20 ml WA20, avec flacon en verre brun pour solution titrante, adaptateurs GL45 et S40, tuyaux souples, tube d'égouttage et pointe de titration avec électrode pH combinée IL-pHT-A120MF-DIN-N et solutions tampon	285220170

SI Analytics

SI Analytics GmbH • Hattenbergstraße 10 • 55122 Mainz • Germany
 Telephone +49 (0) 61 31-66 51 11 • Fax +49 (0) 61 31-66 50 01
www.si-analytics.com • support@si-analytics.com